

## RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL PROCESO DE SELECCIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA CP-018-2022

Señor:

**JUAN CARLOS MARTÍNEZ C.**

Representante legal

QUINBERLAB

Correo electrónico: [licitaciones@quinberlab.com.co](mailto:licitaciones@quinberlab.com.co)

**Asunto:** Dar respuesta observaciones planteadas al proyecto de términos de la convocatoria pública No. CP-018-2022

Señores interesados:

Después de la verificación y análisis de las observaciones generadas al proyecto de término de condiciones publicado el día 6 de junio de 2022, se procede a dar respuesta a las observaciones presentadas por el señor **JUAN CARLOS MARTÍNEZ**, actuando como Representante legal de la Sociedad QUINBERLAB S.A. , mediante el correo electrónico: [licitaciones@quinberlab.com.co](mailto:licitaciones@quinberlab.com.co) , las cuales fueron remitidas dentro del plazo de formulación de las mismas indicado en el cronograma.

Precisamos que las respuestas emitidas por la entidad para aclarar su contenido deben hacer parte del término de condiciones para conocer el sentido, alcance e interpretación de sus cláusulas y así lo hemos plasmado en los términos de condiciones:

*“La discusión de si la aclaración realmente modifica, complementa o precisa el contenido de una estipulación del pliego no es asunto de poca monta, y lo procedente es considerar y aportar al proceso todas las manifestaciones de voluntad de la administración orientadas a definir las reglas obligatorias durante el proceso precontractual y contractual, para desentrañar su sentido y efectuar el control de legalidad.*

*Por ello, las respuestas remitidas por la administración a las preguntas de los interesados, consolidan y precisan las reglas del pliego. (Sentencia del Consejo de Estado – Sección Tercera – Referencia: Expediente 15.123 de 31 de Octubre de 2007 – Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo).*

Así las cosas, absolvemos los interrogantes, presentados en su escrito:

### **Observación N° 1:**

#### **5. Requerimientos técnicos específicos analizador de hematología en apoyo tecnológico:**

**Cantidad: 03**



Solicitamos amablemente a la entidad corregir la cantidad de equipos requerida debido a que corresponde a dos (02) analizadores de hematología en apoyo tecnológico, Principal y backup

### Observación No. 2:

#### 5. Requerimientos técnicos específicos analizador de hematología en apoyo tecnológico:

**Cantidad: 03**

Dando continuidad a la observación anterior referente a los analizadores de hematología en apoyo tecnológico el faltante corresponde a una complejidad más baja, por lo tanto; sugerimos las siguientes características:

- Equipo automatizado de tubo abierto.
- Principio de detección Citometría de Flujo, con laser semiconductor o equipos con Citometria de flujo fluorescente y enfoque hidrodinámico o impedancia eléctrica.
- Pantalla táctil.
- Reporte mínimo de 31 parámetros y alarmas para anomalías morfológicas de las células (células inmaduras, alarma de normoblastos, alarma de linfocitos atípicos y alarma de blastos).
- Capacidad de 60 muestras por hora.
- Reactivos libres de cianuro.
- Conexión bidireccional a LIS.

### Observación No. 3:

#### 7. Requerimientos técnicos específicos hematología (analizador) en apoyo tecnológico (backup):

**Cantidad 01**

Solicitamos amablemente a la entidad corregir las características técnicas de este analizador; sugerimos:

- Analizador automatizado de hematología con capacidad de medición de 31 parámetros y diferencial de 5 partes.
- Capacidad de procesamiento de mínimo 120 pruebas por hora.
- Pantalla táctil.
- Reactivos libres de cianuro.
- Automuestreador con capacidad de 150 tubos.
- Conexión bidireccional a LIS.
- Posee tres sistemas de muestreo: Modo manual tubo abierto, modo manual tubo cerrado y el automuestreador, que transporta, mezcla, identifica, y aspira automáticamente las muestras en tubos cerrados.



**Observación No. 4:**

**9. Requerimientos técnicos específicos lector de tiras para uroanálisis en apoyo tecnológico:**

**Cantidad 03**

Solicitamos amablemente a la entidad corregir la cantidad de equipos requerida debido a que corresponde a dos (02) analizadores de lector de tiras para uroanálisis en apoyo tecnológico.

**Observación No. 5:**

**10. Requerimientos técnicos específicos para coagulación en apoyo tecnológico:**

**Cantidad 02**

Solicitamos amablemente a la entidad corregir la cantidad de equipos requerida debido a que corresponde a un (01) analizador para coagulación en apoyo tecnológico

**Observación No. 7:**

**10. Requerimientos técnicos específicos para coagulación en apoyo tecnológico:**

**Cantidad 02**

➤ Pantalla táctil.

Solicitamos amablemente a la entidad retirar la característica técnica de pantalla táctil debido a que los equipos de esta complejidad funcionan con conexión a monitores externos para mejor visualización de las gráficas y parametrización.

**Observación No. 8:**

**10. Requerimientos técnicos específicos para coagulación en apoyo tecnológico:**

**Cantidad 02**

Dando continuidad a la observación anterior referente a los analizadores para coagulación en apoyo tecnológico el faltante corresponde a una complejidad más baja, por lo tanto; sugerimos las siguientes características:

- Analizador de coagulación automatizado.
- Métodos de medición: coagulométrico, cromogénico, inmunológico.
- Velocidad de mínimo 40 pruebas PT/PTT simultáneas por hora.



- Capacidad a bordo de 10 reactivos, 4 refrigeradas.
- STAT de urgencias.
- Conexión bidireccional a LIS.

**Observación No. 9:**

**14. Requerimientos técnicos específicos para equipos termocicladores en apoyo tecnológico:**

**Cantidad 03**

Solicitamos amablemente a la corregir la cantidad de equipos requerida debido a que corresponde a dos (02) equipos termocicladores en apoyo tecnológico.

**Observación No. 10:**

ANEJO No. 9 PROPUESTA ECONÓMICA						
CODIGO HUV	NOMBRE INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECCION MES	Vir. Unitario con IVA	Vir. Total con IVA	
NUEVO	TIEMPO DE SANGRÍA	PRUEBA	20			

Solicitamos amablemente a la entidad retirar el ítem anteriormente relacionado debido a que esta corresponde a prueba manual y no aplica para esta convocatoria la cual corresponde a apoyo tecnológico.

**Observación No. 11:**

ANEJO No. 9 PROPUESTA ECONÓMICA						
CODIGO HUV	NOMBRE INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECCION MES	Vir. Unitario con IVA	Vir. Total con IVA	
NUEVO	HOMOCISTEÍNA	PRUEBA	20			

Solicitamos amablemente a la entidad retirar el ítem anteriormente relacionado debido a que las plataformas que tiene la entidad instaladas actualmente no procesan esta prueba.

**RESPUESTA HUV:**

Teniendo en cuenta que todas las observaciones realizadas por el interesado son de carácter técnico, y tienen como finalidad que se modifiquen los Anexos Técnicos, todas ellas serán resueltas en este acápite. Dicho esto, se debe mencionar que la Entidad NO ACCEDE a ninguna de las observaciones, teniendo en cuenta que las cantidades y calidades descritas en los anexos técnicos corresponden a la necesidad actual de la entidad, por lo cual, se requiere que cualquier eventual contratista se encuentre en la capacidad de proveerlos en su integridad, conforme a lo



descrito en los documentos contractuales, y conforme a la necesidad del Hospital.


En caso que la Entidad acepte alguna de las observaciones planteadas por el interesado, las mismas será formalizadas mediante adenda al proceso y publicadas en página web [www.huv.gov.co](http://www.huv.gov.co).

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los diez (10) días de junio de dos mil veintidós (2022).



**VIVIANA BOLANOS F.**

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

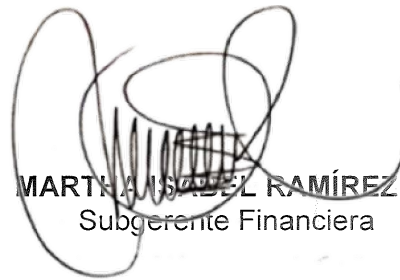

**MARTHA ISABEL RAMÍREZ S.**

Subgerente Financiera



**MARIA FERNANDA SANCHEZ P.**

Jefe Oficina Coordinadora de Apoyo Diagnostico y Terapéutico

Proyectó: Juan Sebastian Bema A. – Profesional Administrativo - AGESOC

Revisó: Monica Andrea Murillo. – Profesional de Laboratorio - AGESOC

